

**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**

Acta de Dictamen Técnico de la Licitación Pública Local No. 26/15561/2016

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 9:20 horas del día 16 de diciembre de 2016, se reunieron en la novena sesión ordinaria los miembros de la comisión de Adquisiciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, en la sala de juntas de la Dirección General, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho, en la colonia Lázaro Cárdenas, para celebrar el acto de dictamen técnico de la licitación pública local SEAPAL **Nº 26/15561/2016** para: SUMINISTRO DE 48 MUESTREO COMPUESTO, 48 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL NOM 001 – SEMARNAT, 12 ANALISIS DBO5 SST, 2 ANALISIS DE BIOSOLIDOS SEGÚN NOM – 004 SEMARNAT/02, 12 ANALISIS COMPOSICION DE BIOGAS, 2 ANALISIS CRETÍ BIOSOLIDO, 20 ANALISIS AGUA POTABLE FUENTES DE ABASTECIMIENTO, 18 ANALISIS DE AGUA POTABLE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1. Con recursos propios. Con la finalidad de determinar cuales de ellos pasan a la siguiente etapa de la licitación, denominada apertura de propuestas económicas, para tal efecto, se hace la siguiente relación de:


Antecedentes:

Que el SEAPAL, convocó mediante publicación en los diarios locales El Occidental Tribuna de la bahía, Milenio y meridiano el día 3 de Diciembre de 2016 a las compañía interesadas en participar en la licitación pública local SEAPAL **Nº 26/15561/2016** para: SUMINISTRO DE 48 MUESTREO COMPUESTO, 48 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL NOM 001 – SEMARNAT, 12 ANALISIS DBO5 SST, 2 ANALISIS DE BIOSOLIDOS SEGÚN NOM – 004 SEMARNAT/02, 12 ANALISIS COMPOSICION DE BIOGAS, 2 ANALISIS CRETÍ BIOSOLIDO, 20 ANALISIS AGUA POTABLE FUENTES DE ABASTECIMIENTO, 18 ANALISIS DE AGUA POTABLE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1. citado en la parte introductiva del presente, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los artículos 1, fracción IV, artículo 8 fracción I, artículo 11 fracción I, y 51 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco; así como los artículos 1 y 19 fracción I, del Reglamento de la ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco del cual 1 empresa recogió las bases de la licitación siendo las siguiente:

Licitante

LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS

GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V.

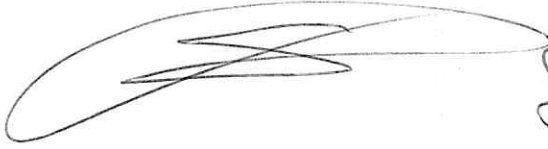
Nere Castillo

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA

Acta de Dictamen Técnico de la Licitación Pública Local No. 26/15561/2016

Con fecha 16 de Diciembre de 2016, entregaron sus propuestas técnicas y económicas, obteniendo así el derecho a participar en la presente licitación y presentó propuesta, misma que se analizan en este acto por los integrantes de la comisión que asisten a esta reunión.

Dictamen:


Con base en el análisis de las propuestas técnicas elaborado por el Comité Técnico de Evaluación (se adjunta cuadro comparativo), se determinó por sus miembros:

La empresa participante LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V. cumple la etapa técnica y adquiere el derecho a participar en la apertura de su propuesta económica.

La empresa participante GRUPO ECOTEC, S.A. cumple la etapa técnica y adquiere el derecho a participar en la apertura de su propuesta económica

En tal virtud el Comité Técnico de Evaluación emite el presente dictamen para que la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones emita el fallo correspondiente.


Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico mismo que firman los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión.

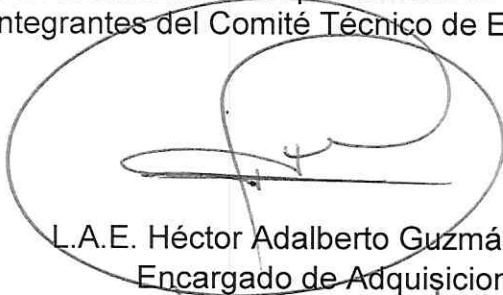

L.A.E. Héctor Adalberto Guzmán Vargas
Encargado de Adquisiciones



Q.F.B. Elba Soraya Topete Camacho
Representante del Área Técnica


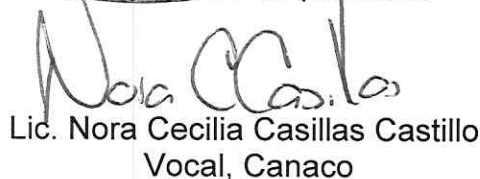


Lic. Nora Cecilia Casillas Castillo
Vocal, Canaco

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA

Acta de Dictamen Técnico de la Licitación Pública Local No. 26/15561/2016

La presente hoja forma parte integral de acta de dictamen técnico de fecha 15 de diciembre del 2016 relativa a la Licitación Pública Local SEAPAL N° 26/15561/2016 para: SUMINISTRO DE 48 MUESTREO COMPUESTO, 48 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL NOM 001 – SEMARNAT, 12 ANALISIS DBO5 SST, 2 ANALISIS DE BIOSOLIDOS SEGÚN NOM – 004 SEMARNAT/02, 12 ANALISIS COMPOSICION DE BIOGAS, 2 ANALISIS CRETÍ BIOSOLIDO, 20 ANALISIS AGUA POTABLE FUENTES DE ABASTECIMIENTO, 18 ANALISIS DE AGUA POTABLE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1.

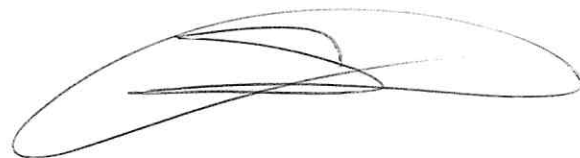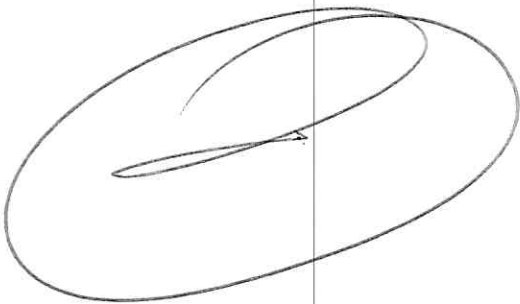


Deia C. Co. 16

SEAPAL VALLARTA

CONCURSO: SEAPAC N° 28/16042/2016

PARTIDA	ABC	ECOTEC		
MUESTREO COMPUESTO	✓	✓		
NOM-001-SEMARNAT-1996	✓	✓		
DBO 5 / SST	✓	✓		
NOM-004-SEMARNAT - 2002	✓	✓		
COMPOSICION DE BIOGAS	✓	POR LABORATORIO EXTERNO		
CRIT	✓	✓		
ANALISIS DE AGUA POTABLE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Fenoles, Cadmio, Aluminio, Organoclorados, Herbicidas, Btex, Trihalometanos	✓	✓		
ANALISIS DE AGUA POTABLE NOM- 127-SSA1-1994 Mod. 2000, con RADIOACTIVIDAD	✓	✓		

ATENTAMENTE

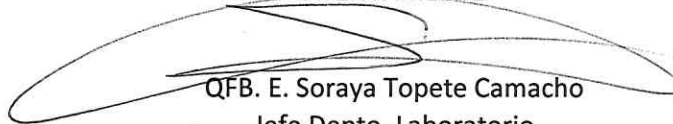
QFB. E. Soraya Topete Camacho
Jefe Depto. Laboratorio

2016/dies 16.